


# Fichier:Group-Biophysical Equipment Group E0ce03a836f36d7900978663c8f25f6c.jpg

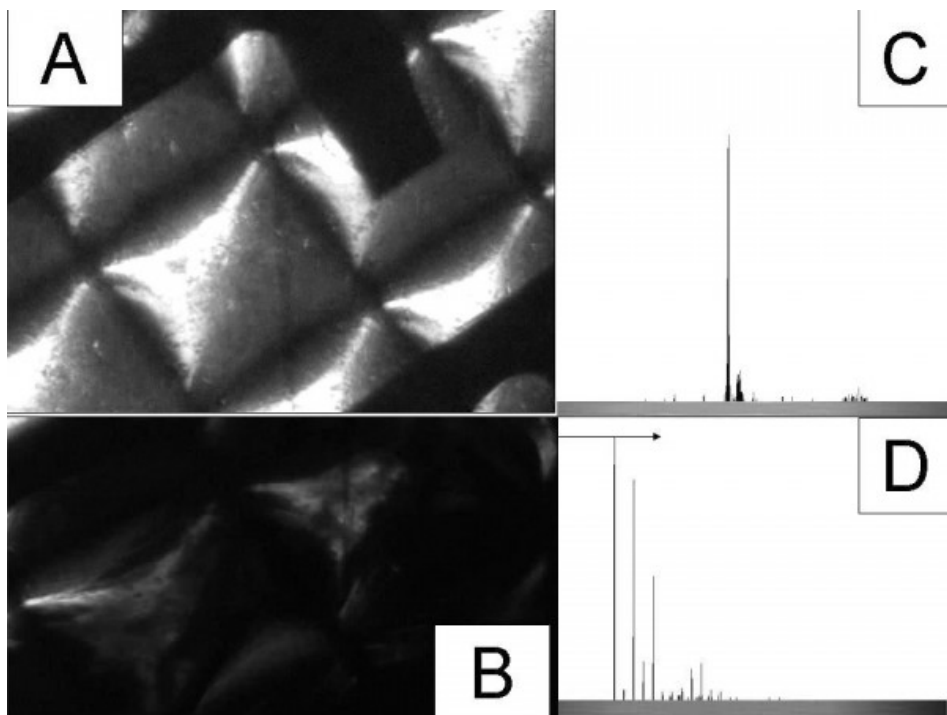

Pas de plus haute résolution disponible.

Group-Biophysical\_Equipment\_Group\_E0ce03a836f36d7900978663c8f25f6c.jpg (600 × 450 pixels, taille du fichier : 37 Kio, type MIME : image/jpeg)

## Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	3 janvier 2024 à 15:50		600 × 450 (37 Kio)	Gradov (discussion   contributions)	

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

## Utilisation du fichier

Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :

CCD-or CMOS-lab-on-a-chip based on discrete converters of different physical and chemical parameters of samples into the optical signals with positional sensitivity for morphometry of non-optical patterns

Group:Biophysical Equipment Group

## Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Commentaire de fichier JPEG	CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90
--------------------------------	---