


Fichier:Controleur de pH capteur ultrason.jpg



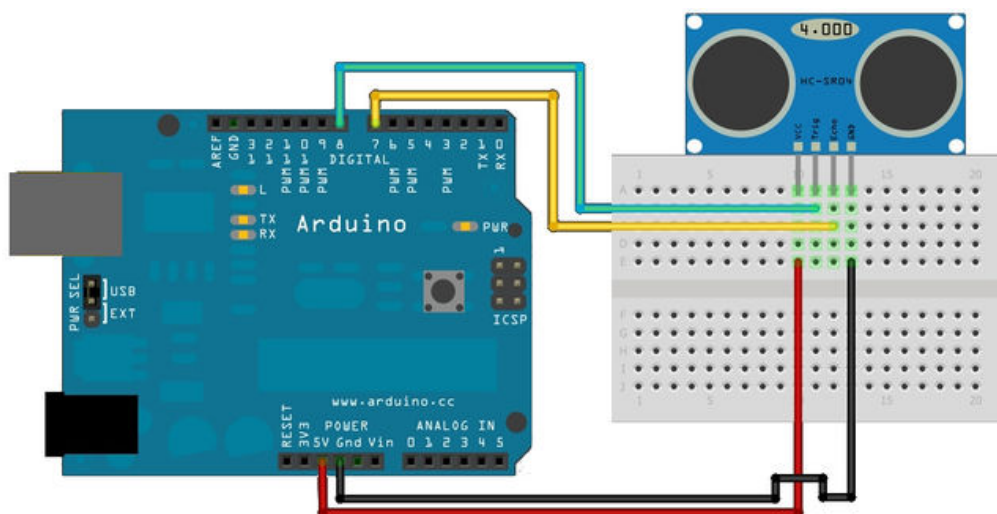

Pas de plus haute résolution disponible.

Controleur_de_pH_capteur_ultrason.jpg (640 × 331 pixels, taille du fichier : 42 Kio, type MIME : image/jpeg)

Controleur_de_pH_capteur_ultrason

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	25 janvier 2019 à 11:16		640 × 331 (42 Kio)	Bencheikh (discussion contributions)	Controleur_de_pH_capteur_ultrason
	24 janvier 2019 à 12:57		458 × 458 (9 Kio)	Bencheikh (discussion contributions)	Controleur_de_pH_capteur_ultrason

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Aucune page n'utilise ce fichier.

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Commentaire de fichier JPEG	File source: http://mchobby.be/wiki/index.php?title=Fichier:HC-SR04-01.jpg
-----------------------------	--